

Relatório de Cotação: Bee 38231

Pesquisa realizada entre 18/03/2021 11:53:25 e 18/03/2021 11:54:05

Relatório gerado no dia 18/03/2021 11:54:48 (IP: 201.88.200.229)

000001

Item 1: prensa para mufla bancada

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3	1	R\$ 1.883,89 (un)	R\$ 1.883,89
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:12802020 UASG:943001	05/01/2021 R\$ 1.772,33
2	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande	NºPregão:142020 UASG:785810	16/10/2020 R\$ 1.691,89
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	NºPregão:1922020 UASG:983781	09/10/2020 R\$ 2.187,46
Valor Unitário			R\$ 1.883,89
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.883,89			
Valor Global:			R\$ 1.883,89

SMS

FMS

Pqpm

Detalhamento dos Itens

Item 1: prensa para mufla bancada

Preço Estimado: R\$ 1.883,89 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.883,89

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	prensa para mufla bancada, modelo hidráulica, capacidade 2 un, acabamento pintura eletrostática, características adicionais manômetro mínimo 100kgf até 3 toneladas, haste co m	
Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 1.772,33
<p>Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</p> <p>Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para a implantação de 8 (oito) serralherias, através do Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.</p> <p>Descrição: PRENSA PARA MUFLA BANCADA - PRENSA PARA MUFLA BANCADA, MODELO HIDRÁULICA, CAPACIDADE 2 UN, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANÔMETRO MÍNIMO 100KGF ATÉ 3 TONELADAS, HASTE CO M</p>		<p>Data: 05/01/2021 09:02</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: NÃO</p> <p>Identificação: NºPregão:12802020 / UASG:943001</p> <p>Lote/Item: 1/38</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 8</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: CE</p>

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.696.467/0001-41 * VENCEDOR *	RM COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO LTDA	R\$ 1.772,33
Marca: BANCANDA Fabricante: BANCANDA Modelo: BANCANDA Descrição: Descrição: PRENSA PARA MUFLA BANCADA, MODELO HIDRÁULICA, CAPACIDADE 2 UN, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANÔMETRO MÍNIMO 100KGF ATÉ 3 TONELADAS, HASTE CO M		
Endereço: AVENIDA G (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 594		Telefone: (85) 3291-4012 / (85) 8837-8155
		000002

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.691,89

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande	Data: 16/10/2020 09:02 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário, equipamentos comuns, médicos e odontológicos) para equipar os novos prédios da Seção de Fisioterapia, 1ª ala de internação, Consultórios, Departamento de Odontologia, Alojamentos e Refeitórios da Policlínica Naval de Rio Grande (PNRG), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..	Identificação: NºPregão:142020 / UASG:785810 Lote/Item: /2 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: PRENSA PARA MUFLA BANCADA - PRENSA PARA MUFLA BANCADA, MODELO HIDRÁULICA, CAPACIDADE 2 UN, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANÔMETRO MÍNIMO 100KGF ATÉ 3 TONELADAS, HASTE CO M	Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: RS
CatMat: 397636 - PRENSA PARA MUFLA BANCADA, HIDRÁULICA, 2 UN, PINTURA ELETROSTÁTICA, MANÔMETRO MÍNIMO 100KGF ATÉ 3 TONELADAS, HASTE COM	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.395.502/0001-52 * VENCEDOR *	DENTAL UNIVERSO EIRELI	R\$ 1.691,89
Marca: ESSENCE DENTAL Fabricante: ESSENCE DENTAL Modelo: ESSENCE DENTAL Descrição: - PRENSA HIDRAULICA 3 TONELADAS MAXX 2 VH - PRENSA HIDRAULICA MAXX 2 UTILIZADA PARA PRENSAGEM DE MUFLAS METALICAS OU EM FIBRAS PARA MICRO-ONDAS, ELIMINANDO AS BOLHAS DE AR E PROPORCIONANDO UMA COPIA FIEL DO MODELO EM GESSO. SISTEMA EUROPEU DE PRENSAGEM - NAO FAZ ESFORCO. MANOMETRO E VALVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO. FORCA DE ATE 3 TONELADAS PRENSAGEM EM APENAS 5 SEGUNDOS UNICA DO MERCADO LIBERACAO DA PRENSAGEM EM APENAS 2 SEGUNDOS PESO LIQUIDO: 15.600 KG PESO BRUTO: 12.800 KG CAPACIDADE: ATE 2 MUFLAS DIMENSOES: 310MM (COMPRIMENTO) X 190MM (LARGURA) X 340MM (ALTURA) 12 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO M - MAX X 2 F ESSENCE DENTAL P NAC RDC 260		
Endereço: R ERE, 34	Nome de Contato: REGIANE	Telefone: (31) 2522-8202 Email: licita@dentaluniverso.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.187,46

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	Data: 09/10/2020 08:33
Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos e de consumo - ceo.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: PRENSA PARA MUFLA BANCADA - PRENSA PARA MUFLA BANCADA, MODELO HIDRÁULICA, CAPACIDADE 2 UN, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANÔMETRO MÍNIMO 100KGF ATÉ 3 TONELADAS, HASTE CO M	SRP: NÃO Identificação: NºPregão:1922020 / UASG:983781
CatMat: 397636 - PRENSA PARA MUFLA BANCADA, HIDRÁULICA, 2 UN, PINTURA ELETROSTÁTICA, MANÔMETRO MÍNIMO 100KGF ATÉ 3 TONELADAS, HASTE COM	Lote/Item: /2S Ata: Link Ata Adjudicação: 14/10/2020 10:00 Homologação: 09/11/2020 10:33 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.650.212/0001-42

SAULUS DISTRIBUIDORA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI

R\$ 2.187,46

* VENCEDOR *

Marca: MARCON

Fabricante: MARCON

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: Prensa hidráulica

000003

Endereço:

RUA SAO PEDRO, 529 A

Nome de Contato:

Ivana Mercedes

Telefone:

(75) 3282-0644

Email:

ivanamercos@hotmail.com

FRETE GRÁTIS PARA TODO BRASIL

(https://www.dentalabs.com.br/ofertas-imperdiveis.html)

Entrar (https://www.dentalabs.com.br/customer/account/login) ou Cadastre-se (https://www.dentalabs.com.br/customer/account/create/)

Minha conta (https://www.dentalabs.com.br/customer/account) | Fale conosco (https://www.dentalabs.com.br/customer/faq) | Meu pedido (https://www.dentalabs.com.br/customer/order/history) | Frete grátis

11 95162-6951 | 1-pt_BR&phone=5511951626951

Equipamentos para laboratório de prótese.html | Prensa Hidráulica Maxx 2 VH

Recomendar para amigo (https://www.dentalabs.com.br/sendfriend/product)

Facebook share (https://www.facebook.com/share/s=100011951626951) para status de perfil

laboratório de prótese.html | Prensa Hidráulica Maxx 2 VH

Preço: R\$ 0,00

Prensa Hidráulica Maxx 2 VH - lb. 6049

R\$ 1.896,00

ou 12x R\$ 158,00 no cartão s/ juros

R\$ 1.801,20 à vista no boleto

Pague no boleto com 5% de desconto!

Clique sobre a bandeira para informações de parcelamento

VISA | MASTERCARD | AMEX | BOLETO

CHAT

Frete e prazo: não sei meu cep

CALCULAR


42F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e9542Fp12F42FPrensa_2_1.jpg&p[title]=Prensa+Hidráulica+Maxx+2+VH

Avisar-me quando o produto chegar

(https://www.dentalabs.com.br/productalert/add/stock/product_id/218/uenc/aHR0cCIH

PRF

000004



Baixar manual do produto (https://www.dentalabs.com.br/media/pdf/manuais/Prensa_Maxx_manual.pdf)

Passo o mouse e amplie

DETALHES



DESCRIÇÃO:

- Utilizada para prensagem de mufas metálicas ou em fibras para micro ondas, eliminando as bolhas de ar, proporcionando uma cópia fiel do modelo em gesso.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- Suavidade
- Facilidade de prensagem
- Necessita pouco esforço físico na hora da prensagem.
- Manômetro de aferição de pressão.
- Prensa construída para até 2 mufas, sendo também projetada para mufas utilizadas em forno de micro ondas, com manômetro de aferição.
- Controle total nas diversas fases da prensagem.
- Indispensável o uso em laboratório, pois o operador pode controlar as pressões desnecessárias sobre as mufas, dispensando pouco esforço físico na hora da prensagem.
- Colocar a mufla na prensa hidráulica e apertá-la proporcionando o correto escoamento da resina e a saída do excesso para fora da mufla. Estabilidade dimensional da prótese.
- O operador não corre o risco de se machucar, como por exemplo, lesionar a coluna vertebral ou nervos e músculos das costas e pescoço.
- Estabilidade dimensional da prótese.
- Controle total nas diversas fases de prensagem.
- Serve também para mufas parciais.
- Não necessita instalação.
- A linha VH tem 12 meses de garantia, com baixo custo.
- Possui manômetro de aferição de pressão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Peso Líquido: 15.6 Kg
- Dimensões: 310mm (comprimento) x 190mm (largura) x 340mm (altura)
- Força até 4 Toneladas
- Haste: 19cm
- Capacidade: até 2 mufas

Fabricante: VH

Garantia: 12 meses

Origem: Brasil

Receba ofertas imperdíveis em seu e-mail!

Inscreva-se aqui

Enviar

Teleendas / Site
11 55810975 (tel:01155810975)
11 95162-6951 Whatsapp
(http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511951626951)
sac@dentalabs.com.br
(mailto:sac@dentalabs.com.br)

Ajuda
Quem Somos
(https://www.dentalabs.com.br/quem-somos)
Política de Privacidade
(https://www.dentalabs.com.br/politica-de-privacidade)
Política de Pagamento
(https://www.dentalabs.com.br/politica-de-pagamento)
Política de Troca e Devoluções
(https://www.dentalabs.com.br/politica-de-troca-e-devolucoes)
Política de Segurança
(https://www.dentalabs.com.br/politica-

Meus Pedidos
Acompanhe seus pedidos
(https://www.dentalabs.com.br/sales/order-history)
Minha conta
(https://www.dentalabs.com.br/customer/account)

Siga Nosso Instagram!
Acompanhe nossos posts
(https://www.instagram.com/dentalabs/)

"LOJA FÍSICA SP : TELEVENDAS (11) 3931-0440"

SHOPPING do PROTÉTICO

R. Mariana de Chaves 279, Freguesia do Q. São Paulo - cep 02738-100 (11) 3931-0440

Compre Novos ou usados com garantia! Faça sua oferta! WhatsApp (11) 9 4531-9614

Página Inicial Formas de pagamentos Rastrear seu pedido WhatsApp clique aqui entre ou cadastre-se Buscar

Atendimento cliente TELEVENDAS REFERÊNCIAS DA LOJA Quem Somos ACESSO POR GPS vender seu usado?

Nosso e-mail USADOS E SEMI-NOVOS EQUIPAMENTOS? Consulta comercial CADASTRO Contato

Prensa(IMPRESSORA 3D)
RESINAS 3D# SCANER DS
9000# COMPRAR FRETE
FIXOAcesso setor de
usados

Articuladores

Artigos
(odontologia)

Artigos (protese)

ASPIRADOR de
bancada

Bomba de Vácuo

CADEIRAS DA
CALTINE

Caixa centrífuga

Caixa de polimento

Caneta A.R. para
protese dentariaCentrífuga para
fundir

Cortador de gesso

Eletrolítico PPR

Espatula elétrica

Espatulador a
vácuo

Forno de aneis

forno de porcelana

Fotopolimerizadora

Injetora Flex

Jato de areia

Maçarico de
fundição

Macro modelo

Martetele
pneumáticoMaterial de
consumoMicro motor de
bancada

motor de chicote

Motor de polimento

motor poltriz para
PPR

Outros

Panela Elétrica

Panela ortodontica

Plastificadora

Polidora química

Programa Prótese

Solda Ponto


Troquelizador

ultrassom

VAPORJET

Vibrador de gesso

z*Catálogos

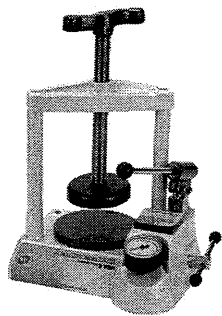Em caso de dúvida
através de pagamento

PRENSA HIDRAULICA VH R\$ 1.580,00 A VISTA ()

R\$ 1.664,00

3x de R\$ 554,66 sem juros

mais informações



CHECKLIST: fev2021

*DESPACHO EM: 9a 40 dias utei

FORMA/PAGTO: A VISTA

PRODUTO: NOVO

MARCA: VH

CAPACIDADE: 3 TONELADAS

Garantia: 1 ANO

Quantidade: 1

Adicionar ao Carrinho

Frete CEP:

não sei meu CEP

SEJA BEM VINDO À
VITRINE DO
PROTÉTICO, O SEU
CENTRO DE COMPRAS.site: LOJA1 >
www.shoppingdoproteti
co.com.bremail: Loja1
vendas@shoppingdoprot
etico.com.brLOJA2
www.shoppingdoproteti
co.loja2.com.bremail: Loja2
shoppingdoprotetico@g
mail.comhttps://pagseguro.uol.c
om.br/

Prensa Hidráulica Maxx - Essence Dental

**Prensa Hidráulica**

Utilizada para prensagem de mufas metálicas ou em fibras para micro ondas. Sistema Europeu de Prensagem Para até 3 ton. Prensagem em apenas 5 segundos Liberação da prensagem em apenas 2 segundos

Características e Vantagens:

- Prensa construída para o uso com 2 (duas) mufas;
 - Possui manômetro de aferição de pressão
 - Controle total nas diversas fases da prensagem;
 - indispensável o uso em laboratório, pois o operador pode controlar a prensagem sobre as mufas, necessitando de pouco esforço.
 - Indispensável o uso em laboratório, pois o operador pode controlar as pressões desnecessárias sobre as mufas, dispendendo pouco esforço físico na hora da prensagem.
 - Colocar a mufra na prensa hidráulica e apertá-la proporcionando o correto escoamento da resina e a saída do excesso para fora da mufra.Estabilidade dimensional da prótese.
 - O operador não corre o risco de se machucar como, por exemplo, deslocar a coluna vertebral ou nervos e músculos das costas e pescoço.
 - Controle total e preciso nas fases de prensagens.
- A linha Vh tem 18 meses de garantia, com baixo custo.

Modelo: PRENSA HIDRAULICA MAXX

Peso líquido: 15,050 kg

Peso bruto: 16.650 kg

Dimensões: 310mm (comprimento), 340mm (altura) e 190mm (largura).

Haste : 19 cm - Capacidade : até 2 mufas


*Configuração:21.36.35.13p



(https://www.odontoequipamentos.com.br/wishlist)

Entre ou Cadastre (https://www.odontoequipamentos.com.br)

P. Haja

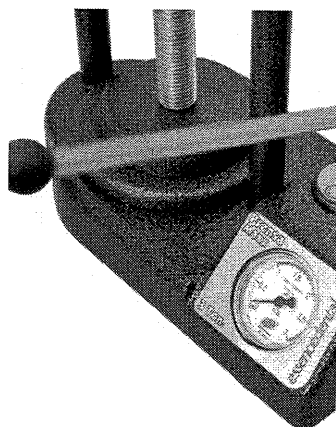

REF: #000917 Prensa Hidráulica Maxx 2 Essence Dental VH

RS 1.896,00
Em 10x de RS189,60 sem juros

Opções de parcelamento

Utilizada para prensagem de mufas metálicas ou em fibras para micro-onde, eliminando as bolhas de ar e proporcionando uma cópia fiel do modelo em gesso.

- 1 +

Adicionar ao carrinho

Adicionar Aos Favoritos (https://www.Odontoequipamentos.Com.Br/Wishlist/Index/Add/Product/411/Form_key/URp

Calcular frete e prazo OK

Formas de Parcelamento


1x de R\$ 1.896,00 sem juros	6x de R\$ 316,00 sem juros
2x de R\$ 948,00 sem juros	7x de R\$ 270,86 sem juros
3x de R\$ 632,00 sem juros	8x de R\$ 237,00 sem juros
4x de R\$ 474,00 sem juros	9x de R\$ 210,67 sem juros
5x de R\$ 379,20 sem juros	10x de R\$ 189,60 sem juros

Prensa Hidráulica Maxx 2 Essence Dental VH


RS 1.896,00
Em 10x de RS189,60 sem juros

Adicionar ao carrinho

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511955557463&text=O%3A1%2C%20ludo%20em%3F%0AEu%20venho%20de%20seu%20site.%0A



Sobre o produto

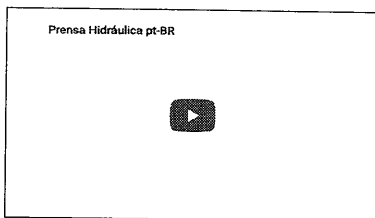

Prensa Hidráulica Maxx 2 VH Essence Dental

- Descrição

É utilizada para prensagem de mufas metálicas ou de fibras utilizadas em microondas, eliminando as bolhas de ar, proporcionando uma prensagem com precisão de trabalho.

- Características e benefícios

- Prensa construída para o uso com 2 (duas) mufas;
- Possui manômetro de aferição de pressão;
- Controle total nas diversas fases da prensagem;
- Indispensável o uso em laboratório, pois o operador pode controlar a prensagem sobre as mufas, necessitando de pouco esforço se necessário;
- O operador não corre o risco de se machucar;
- Estabilidade dimensional da prétese;
- Baixo custo para peças de reposição

- Especificações técnicas

Peso líquido: 11,600 kg
Peso bruto: 12,800 kg
Dimensões: 31,5cm (comprimento), 33cm (altura) e 14,5cm (largura)

- Instalação e uso inicial

- 1º Passo: Prepare as mufas a serem prensadas, tanto metálicas como as de microondas;
 - 2º Passo: Coloque a(s) mufla(s) sobre a flange do embolo.
 - 3º Passo: Gire a haste central no sentido horário até que a flange de encontro preces a(s) mufla(s).
- OBS.: ao chegar ao limite exerça uma ligeira força sobre a mufla.
- 4º Passo: Verifique se a válvula de alívio lateral está fechada, girando a haste lateral sentido horário. Aba chegar na marca indicada no cliquet. É seguida faça a prensagem de prova, movimentando a alavanca pra cima e para baixo, até chegar a 0,5 ton., proporcionando o escoamento do excesso da resina para fora da(s) mufla(s) (quando parar de escoar o excesso da resina, é a fase ideal para a prensagem definitiva);
 - 5º Passo: Faça a prensagem definitiva, de forma lenta, movimentando a alavanca pra cima e para baixo até atingir 1,0 ton. A medida que a força da prensagem for caindo, devido a acomodação da resina no interior da(s) mufla(s), vá movimentando a alavanca pra cima e para baixo até estabilizar a pressão em 1,0 ton.
- OBS.: Nunca use a prensa de forma que o ponteiro do manômetro ultrapasse 3 ton. do mostrador, pois isso pode danificar o equipamento e a(s) mufla(s).
- 6º Passo: Após o tempo necessário de trabalho (conforme especificações técnicas do fabricante de resina), gire a haste lateral no sentido anti horário para soltar a válvula de alívio até chegar em 0 ton. em seguida gire a haste central no sentido anti horário até soltar a(s) mufla(s).


OBS: Nunca roqueie mais do que 1/4 de volta da válvula de alívio, pois poderá ocasionar vazamento do óleo interno.
Nunca movimente a alavanca hidráulica sem as mufas colocadas adequadamente sobre a flange do embolo e operadas com a flange de encontro. Fazendo correto toda as operações citadas acima seu produto terá um excelente funcionamento sem ser danificado.

- Cuidados

Ao movimentar a prensa nunca a segure pela haste lateral, nem pela alavanca e nem pelo manômetro.
Nunca use a prensa de forma que o ponteiro do manômetro ultrapasse 3 ton. do mostrador, pois isso pode danificar o equipamento e a(s) mufla(s)

- Itens Inclusos

- 1 Prensa Hidráulica Maxx 2 VH Essence Dental
- 1 certificado de garantia
- 1 manual de instruções



- Garantia

12 meses (Conta defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto)

* Foto ilustrativa


CAC - Odonto Equipamentos
(11) 2776-7961 / (11) 2776-8294
E-mail: contato@odontoequipamentos.com.br

Informação Adicional

VOLTAGEM	Não
COR	Não
FABRICANTE	VH

Fale conosco, nós estamos online!

Início > Equipamentos > Protécni > Prensa Hidráulica - Protécni

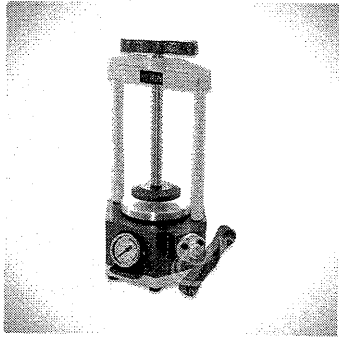

Prensa Hidráulica - Protécni

R\$1.756,00

Em estoque

Comprar

Adicionar ao carrinho




P. Moreira
000007

Informações do produto


Prensagem 4 tonelaças
Sistema hidráulico inferior
Novo formato exclusivo, não necessita fixação na bancada
Capacidade de 3 mufas de microondas ou convencional
Serve também para mufas parciais
Dimensões: 200 x 260 x 340mm

Produtos relacionados




Impressora 3d Phrozen LCD Ref. 09-127 - Odontomega

Comprar




Gotejador Wax Pencil I 110v - Odontomega

Comprar




Compressor - Evox

Ver opções



Painelas Ortodônticas - Protécni

Ver opções



Painela Elétrica - Protécni

Ver opções

111 222 2426 | 11 98116 7452 | WhatsApp


WhatsApp

Site e Site das Redes Sociais

Quem somos

- Política de Privacidade
- Política de Pagamento
- Política de Troca e Devoluções

Fale Conosco



REF: #872

Prensa Hidráulica Protecni

Prensa Hidráulica Protecni
Em 10x de R\$159,60 **R\$ 1.596,00**
sem juros Em 10x de R\$159,60
Opções de parcelamento sem juros

Autômatas para impressão de moldes em gesso.
Indicados para impressão de moldes metálicos ou em fibras para micro ondas, eliminando as bolhas de ar, proporcionando uma cópia fiel do modelo em gesso.

- 1 +


Adicionar ao carrinho

Adicionar Aos Favoritos (https://www.Odontoequipamentos.Com.Br/Wishlist/Index/Add/Product/593/Form_key/URp

Calcular frete e prazo OK

Formas de Parcelamento


1x de R\$ 1.596,00 sem juros	6x de R\$ 266,00 sem juros
2x de R\$ 798,00 sem juros	7x de R\$ 228,00 sem juros
3x de R\$ 532,00 sem juros	8x de R\$ 199,50 sem juros
4x de R\$ 399,00 sem juros	9x de R\$ 177,33 sem juros
5x de R\$ 319,20 sem juros	10x de R\$ 159,60 sem juros

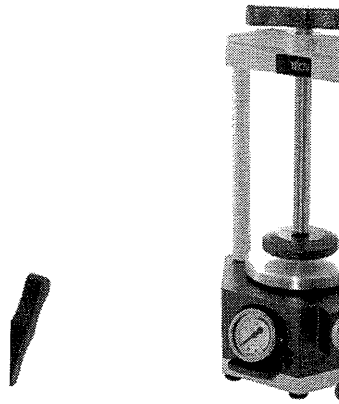

https://www.odontoequipamentos.com.br/protese-dentaria/prensa-hidraulica-protese-dentaria/prensa-hidraulica-protelni_1.png



Sobre o produto

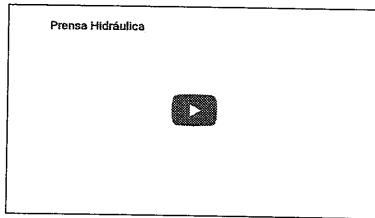

Prensa Hidráulica Protecni 4 Toneladas

- Descrição
Indicado para prensagem de moldes metálicos ou em fibras para micro ondas, eliminando as bolhas de ar, proporcionando uma cópia fiel do modelo em gesso.
A Prensa Hidráulica da Protecni é um equipamento destinado a uso em laboratórios de próteses, utilizado para trabalhos onde exige alta prensagem, garantindo alta qualidade. Utilizado para trabalhos de peças em moldes metálicos ou moldes de fibras, eliminando bolhas de ar.

- Especificações Técnicas
Prensagem 4 toneladas
Sistema hidráulico inferior
Novo formato exclusivo, não necessita fixação na bancada
Capacidade de 3 moldes de microondas ou convencional
Serve também para moldes portáteis
Dimensões: 200 x 200 x 340mm

- Benefícios
A Prensa Hidráulica oferece alta qualidade de prensagem, eliminando o aparecimento de bolhas e absorção de saliva.
Seu material é feito com materiais recicláveis, contribuindo com a reciclagem no meio ambiente.

- Precauções ao utilizar a Prensa Hidráulica Protecni
Devido a Prensa Hidráulica trabalhar com alta pressão, é muito importante tomar cuidado durante seu manuseio.
Leia atentamente o manual de instruções do equipamento para evitar possíveis acidentes.

- Itens inclusos

1 Prensa Hidráulica Protecni 4 Toneladas

- Garantia

12 meses (Contar de feito de fabricação, válido a partir da data de recebimento do produto)

* Foto ilustrativa

CAC - Odonto Equipamentos
(11) 2776-7961 / (11) 2776-8294
E-mail: contato@odontoequipamentos.com.br

Informação Adicional

VOLTAGEM	Não
COR	Não
FABRICANTE	PROTECNI
TAMANHO	Não

Avaliações

Queremos saber sua opinião

Como você avalia este produto? *

☆☆☆☆☆

Nome e Sobrenome

Título

Comentário

ENVIAR COMENTÁRIO

P. J. Fernandes

000008

Fale conosco, nós estamos online!

000000

PREFEITURA DE GOIANIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAG.: 001

DATA: 15/03/2021

CENIRO CUSTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CADASTRO: 438600 NEYRLENE CAVALCANTI MOREIRA BOR

PEDIDO DE COMPRA : 125 / 2021 PROCESSO: 0 PROC.BEE: 38231

ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	QIDE UN	VLU ESTIMADO	VLU ULT.ENTRADA
1	457175	PRENSA BANCADA ACO 4 TON	2,00 UN	1.596,00	0,00

VALOR TOTAL ESTIMADO (PELO MENOR PRECO) : 3.192,00
TOTAL PELA ULTIMA ENTRADA : 0,00

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECES
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA, CONFORM
E MEMORANDO N° 069/2021 DA GERENCIA DE GESTAO DE EQUIPAMENTOS
MEDICO- HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Especial de Licitação
[Assinatura]
Clerleis Rodrigues Lopes
Presidente/Coordenador - Decreto Nº 296/2021
DEPTO DE COMPRAS

DIRETOR (A) FINANCEIRO (A)

DIRETOR (A) PRESIDENTE

SEDETEC

COM5273N

PREFEITURA DE GOIANIA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 CENTRO CUSTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ESTIMATIVA DE PRECO DO PEDIDO: 125 / 2021
 PROCESSO: DOTACAO:

PAG.: 000010

DATA PEDIDO : 15/03/2021

ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	FORNECEDOR	Q/DE	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	457175	PRENSA BANCADA ACO 4 TON		2,00 UN		
	880442	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS			1.596,0000	3.192,0000
	399256	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE			1.664,0000	3.328,0000
	392235	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S M S			1.691,8900	3.383,7800
	852805	PREFEITURA DE MARICA			1.756,0000	3.512,0000
	4855	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.772,3300 X	3.544,6600
	394394	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIR			1.896,0000	3.792,0000
	462993	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA			1.896,0000	3.792,0000
	34541	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA			2.187,4600	4.374,9200
		MEDIA.....			1.807,4600	3.614,9200
		MEDIA COM 2 DECIMAIS....			1.807,46	3.614,92
		MEDIANA.....			1.764,1650	3.528,3300
		MEDIANA COM 2 DECIMAIS..			1.764,16	3.528,32

VALOR TOTAL ESTIMADO (MENOR PRECO) ->	3.192,0000
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIA) ----->	3.614,9200
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIANA) ---->	3.528,3300
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIA C/ 2 DECIMAIS) ----->	3.614,92
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIANA C/ 2 DECIMAIS) ---->	3.528,32

FORNECEDORES COTADOS	DATA COTACAO	VENDEDOR	TELEFONE
4855 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18/03/2021	PREÇOS OFICIAIS/GOVERNAMENTAIS	62 5241500
34541 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	18/03/2021	PREÇOS OFICIAIS/GOVERNAMENTAIS	62 0
392235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S M S	18/03/2021	PREÇOS OFICIAIS/GOVERNAMENTAIS	62 35241588
394394 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	18/03/2021	INTERNET	0 0
399256 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	18/03/2021	INTERNET	0 0
462993 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA	18/03/2021	INTERNET	0
852805 PREFEITURA DE MARICA	18/03/2021	INTERNET	0
880442 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS	18/03/2021	INTERNET	0

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECES
 SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA, CONFORM
 E MEMORANDO N° 069/2021 DA GERENCIA DE GESTAO DE EQUIPAMENTOS
 MEDICO- HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Comissão Especial de Licitação

Clerleis Rodrigues Lopes
 Coordenador - Decreto Nº 296/2021

DEPTO DE COMPRAS

DIRETOR (A) FINANCEIRO (A)

DIRETOR (A) PRESIDENTE

SEDETEC

SMP5267N



PROCESSO BEE Nº :38.231

INTERESSADO :Gerência Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos

ASSUNTO : Aquisição

000011

DESPACHO Nº 073/2021 – Encaminhem-se os autos ao GGEM para análise da Estimativa de Preços realizada, devendo ser emitido **PARECER TÉCNICO**, justificando o aceite ou não do que está sendo apresentado.

Informamos que utilizamos para Pesquisa /Estimativa de Preços de Mercado valores obtidos através de: **Pesquisa realizada na Plataforma Banco de Preços (PREÇOS OFICIAIS) esites especializados na INTERNET.**

Solicitamos a **MÁXIMA URGÊNCIA** no envio do Parecer para a continuidade dos autos.

Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, aos 18(dezoito) dias do mês de março de 2.021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Especial de Licitação

Clerleis Rodrigues Lopes

Presidente/Coordenador - Decreto Nº 296/2021

AP
Ana Paula Silvestre

Gerência de Compras



PROCESSO: BEE 38231

ASSUNTO: Parecer técnico

DESPACHO Nº 395/2021

Em atenção ao despacho nº 073/2021 via processo supracitado, segue o seguinte parecer:

ITEM	DESCRIÇÃO	PARECER
1	<p>Prensa hidráulica para prensagem de muflas convencional (metálicas) ou de fibras para microondas e muflas parciais, visando eliminar bolhas, resultando em uma cópia fiel do modelo de gesso nos serviços de laboratório de prótese dentária. Prensagem de 3 a 4 toneladas e capacidade de 2 a 3 muflas de microondas ou convencional. Presença de Manômetro de aferição de pressão, possibilitando o controle nas diversas fases de prensagem. Sistema hidráulico inferior.</p> <p>Marca referência: qualidade igual ou superior à Essence Dental.</p>	<p>A cotação da Prefeitura Municipal de Inhumas atende a especificação mínima exigida.</p> <p>A cotação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre atende a especificação mínima exigida.</p> <p>A cotação do Fundo Municipal de Saúde SMS atende a especificação mínima exigida.</p> <p>A cotação da Prefeitura Municipal de Maricá atende a especificação mínima exigida.</p> <p>A cotação da Secretaria Municipal de Saúde não atende a especificação mínima exigida.</p> <p>A cotação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro atende a especificação mínima exigida.</p> <p>A cotação da Prefeitura Municipal de Itajá atende a especificação mínima exigida.</p> <p>A cotação da Prefeitura Municipal de Goiânia atende a especificação mínima exigida.</p>

À Comissão de Licitação para providências subsequentes.

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos, aos 22 dias do mês de março de 2021.

Camilla Gomes Urzêda

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos
Decreto 345/2021

PREFEITURA DE GOIANIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAG.: 001

DATA: 15/03/2021

CENTRO CUSTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CADASTRO: 438600 NEYRLENE CAVALCANTI MOREIRA BOR

PEDIDO DE COMPRA : 125 / 2021

PROCESSO: 0 PROC.BEE: 38231

ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	QIDE UN	VLU ESTIMADO	VLU ULT.ENTRADA
1	457175	PRENSA BANCADA ACO 4 TON	2,00 UN	1.596,00	0,00

VALOR TOTAL ESTIMADO (PELO MENOR PRECO): 3.192,00

TOTAL PELA ULTIMA ENTRADA : 0,00

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECES
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA, CONFORM
E MEMORANDO N° 069/2021 DA GERENCIA DE GESTAO DE EQUIPAMENTOS
MEDICO- HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Comissão Especial de Licitação

Clerleis Rodrigues Lopes
Presidente/Coordenador - Decreto N° 296/2017

DEPTO DE COMPRAS

DIRETOR (A) FINANCEIRO (A)

DIRETOR (A) PRESIDENTE

SEDETEC

COM5273N

PREFEITURA DE GOIANIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAG.: 1

CENTRO CUSTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESTIMATIVA DE PRECO DO PEDIDO: 125 / 2021

DATA PEDIDO : 15/03/2021

PROCESSO: DOTACAO:

ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	FORNECEDOR	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	457175	PRENSA BANCADA ACO 4 TON		2,00 UN		
			880442 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS		1.596,0000	3.192,0000
			399256 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		1.664,0000	3.328,0000
			392235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S M S		1.691,8900	3.383,7800
			852805 PREFEITURA DE MARICA		1.756,0000	3.512,0000
			394394 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIR		1.896,0000	3.792,0000
			462993 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA		1.896,0000	3.792,0000
			34541 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		2.187,4600	4.374,9200
			MEDIA.....		1.812,4785	3.624,9570
			MEDIA COM 2 DECIMAIS....		1.812,47	3.624,94
			MEDIANA.....		1.756,0000	3.512,0000
			MEDIANA COM 2 DECIMAIS..		1.756,00	3.512,00

VALOR TOTAL ESTIMADO (MENOR PRECO) ->	3.192,0000
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIA) ----->	3.624,9570
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIANA) ---->	3.512,0000
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIA C/ 2 DECIMAIS) ----->	3.624,94
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIANA C/ 2 DECIMAIS) ---->	3.512,00

FORNECEDORES COTADOS	DATA COTACAO	VENDEDOR	TELEFONE
34541 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	18/03/2021	PREÇOS OFICIAIS/GOVERNAMENTAIS	62 0
392235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S M S	18/03/2021	PREÇOS OFICIAIS/GOVERNAMENTAIS	62 35241588
394394 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	18/03/2021	INTERNET	0 0
399256 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	18/03/2021	INTERNET	0 0
462993 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA	18/03/2021	INTERNET	0
852805 PREFEITURA DE MARICA	18/03/2021	INTERNET	0
880442 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS	18/03/2021	INTERNET	0

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECES
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA, CONFORM
E MEMORANDO N° 069/2021 DA GERENCIA DE GESTAO DE EQUIPAMENTOS
MEDICO- HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Especial de Licitação

Clerleis Rodrigues Lopes
Presidente/Coordenador - Decreto N° 296/2021

DEPTO DE COMPRAS

DIRETOR (A) FINANCEIRO (A)

DIRETOR (A) PRESIDENTE

SEDETEC

SMP5267N




**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde
Comissão Especial de Licitação
Gerência de Compras

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Eu Karina Ferreira do Amaral – Mat.: 911550 declaro para os devidos fins, e, em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa CGM nº 001/2018, que os preços referenciais constantes na Planilha de Formação de Preços (**ESTIMATIVA DE PREÇO DO PEDIDO**), visando subsidiar a aquisição de prensa hidráulica para muflas odontológicas, estão de acordo com os fornecidos pelos fornecedores interessados em atender à solicitação de orçamento ou averiguados por ocasião da Pesquisa de Preços realizada com o fim de alcançar os valores praticados no mercado local / regional / nacional atualmente, conforme demonstram os documentos juntados aos autos do Processo **BEE n. 38231**.

Goiânia, 31 de março de 2021.


Karina Ferreira do Amaral – Mat.: 911550
Comissão Especial de Licitação
Gerência de Compras