



Parecer Técnico: nº 009/2021

Goiânia, 07 de julho de 2021

PROCESSO: 32687/2020
INTERESSADO: Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA
MUNICÍPIO: Goiânia
ASSUNTO: Parecer Técnico
DATA: 07 de Julho de 2021

I – DAS INFORMAÇÕES

1. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021;
2. OBJETO: Análise da proposta técnica da empresa **Worldtech Comercial e Serviços EIRELI-ME** para aquisição de equipamento analisador de gases (compostos orgânicos voláteis – VOC), para atender a Agência Municipal de Meio Ambiente, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. Por intermédio do pregão eletrônico nº 008/2021, cuja abertura ocorreu no 02/07/2021, às 09:00 horas.
3. ASSUNTO: Habilitação técnica do equipamento da licitação.
4. INTERESSADO: Comissão Geral de Licitação da Secretaria da Administração – CGL.

II - DA ANÁLISE DA CAPACIDADE OPERACIONAL

Acerca da análise de comprovação de capacidade operacional do equipamento analisador de gases (compostos orgânicos voláteis – VOC), oferecido para atender a Agência Municipal de Meio Ambiente. Constatamos as seguintes incoerências entre as especificações do edital e da especificação oferecido pela empresa:

ESPECIFICAÇÃO DIVERGENTE DO EQUIPAMENTO DO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	ANÁLISE
Range dinâmico de 1ppb a até 15.000 ppm para VOC;	Range dinâmico de 1ppb a até 20.000 ppm para VOC;	Negativa abaixo da especificação
Bateria recarregável com estimativa de tempo de 24 horas e certificadas para uso em áreas classificadas	Bateria recarregável com estimativa de tempo de 30 horas e certificadas para uso em áreas classificadas	Negativa abaixo da especificação
IP66/67 contra ingresso de água e poeira.	IP65 contra ingresso de água e poeira.	Positiva acima da especificação
MARCA ALMONT BRASIL MODELO 910-0901-PT-R		



Após detida análise, *afirmo* que a licitante empresa *Worldtech Comercial e Serviços EIRELI-ME* apresentou um equipamento *ABAIXO* das especificações técnicas, *NÃO* atendendo as exigências mínimas exigidas pelo edital da Tomada de Preços n. 008/2021 para a execução do objeto deste certame. E uma especificação técnica *ACIMA* da exigência solicitada.

II - DA ANÁLISE DO PREÇO DO PRODUTO


Quanto TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 informamos que prevalece o MENOR PREÇO para aquisição na licitação.

III - DA CONCLUSÃO

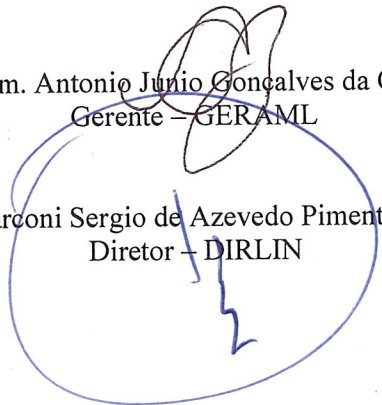
Diante do exposto, opto, destarte:

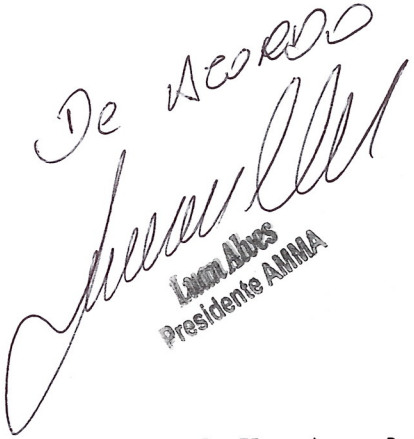
- a. Não está apta, tecnicamente, para participar do certame a empresa *Worldtech Comercial e Serviços EIRELI-ME* onde apresenta para aquisição de equipamento analisador de gases (compostos orgânicos voláteis – VOC), para atender a Agência Municipal de Meio Ambiente, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos por intermédio do pregão eletrônico nº 008/2021, cuja abertura ocorreu no 02/07/2021, às 09:00 horas.
- b. Que seja solicitada a adequação do equipamento referente ao item:
- Range dinâmico de 1ppb a até 20.000 ppm para VOC;
 - Bateria recarregável com estimativa de tempo de 30 horas e certificadas para uso em áreas classificadas
- c. Que mantenha o restante da proposta de especificação dos demais itens.

É o parecer.


Raul Rodrigues de Freitas Junior
Técnico em Química
CFQ 192359


Quim. Antonio Junio Gonçalves da Cruz
Gerente – GERAML


Marconi Sergio de Azevedo Pimenteira
Diretor – DIRLIN

De acordo

Ivan Alves
Presidente AMMA