

Parecer Técnico: nº. 017 / 2021

Goiânia, 15 de julho de 2021

PROCESSO: 32687/2020
INTERESSADO: Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA
MUNICÍPIO: Goiânia
ASSUNTO: Despacho 116/202/GERPRE
DATA: 15 de Julho de 2021

I. DAS INFORMAÇÕES:

1. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021;
2. OBJETO: Análise da proposta técnica da empresa *Andréia Liguori Cardoso, CNPJ 29.218.243/0001-83 (andamento 19 do subprocesso 32687/1) 2ª colocada arrematante do item 1*, para aquisição de equipamento analisador de gases (compostos orgânicos voláteis – VOC), para atender a Agência Municipal de Meio Ambiente, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. Por intermédio do pregão eletrônico nº 008/2021, cuja abertura ocorreu no 02/07/2021, às 09:00 horas.
3. ASSUNTO: Habilitação técnica do equipamento da licitação.
4. INTERESSADO: Comissão Geral de Licitação da Secretaria da Administração – CGL.

II. DA ANÁLISE DA CAPACIDADE OPERACIONAL:

Acerca da análise de comprovação de capacidade operacional do equipamento analisador de gases (compostos orgânicos voláteis – VOC), oferecido para atender a Agência Municipal de Meio Ambiente. Constatamos as seguintes incoerências entre as especificações do edital e da especificação oferecido pela empresa:



ESPECIFICAÇÃO DIVERGENTE DO EQUIPAMENTO DO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	ANÁLISE
DESCRIÇÃO DO PRODUTO Monitor de Sinais Vitais BM5 - Bionet O BM5 fornece dados vitais do paciente de forma precisa, rápida e fácil de analisar, excelente visibilidade das informações e flexibilidade de parâmetros. • ECG – Respiração – Oximetria – Pressão Não Invasiva – 2 Temp – 2 PI • Módulo de Capnografia Main/Side Stream (Opcional) • Tela TFT LCD colorida de alta resolução • Análise do segmento ST, arritmias e detecção de marcapasso • Bateria de Lítio de alta performance, integrada para melhor portabilidade • Memória interna para 128 horas de armazenamento de dados • Pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos • Alarmes visuais/sonoros, ajustáveis e programáveis • Conexão com central monitorização via cabo ou wireless • Alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme • Suporte para fixação em macas integrado na alça • Impressora térmica de alta resolução (opcional) • Saída VGA para conexão com monitor externo (opcional) • Congelamento de imagem e cálculo de drogas • Registro 80070210007 Processo 25351.056424/2009-66 Origem do Produto FABRICANTE: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO • Analisador portátil de benzeno e VOC em ppb com sensor PID; • Range dinâmico de 1ppb a até 20.000 ppm para VOC; • Resolução para benzeno em 10 ppb e leitura máxima em 40 ppm; • Pacote Health & Safety – cálculo de TWA + Memória de Dados; • Interface intuitiva e amigável; • Design robusto, com capa emborrachada; • Bateria recarregável com estimativa de tempo de 30 horas e certificadas para uso em áreas classificadas; • Segurança Intrínseca: ATEX, IECEx; • Alarme sonoro de 95dBA; • Visor LED e alarme com vibração; • IP65 contra ingresso de água e poeira.	NEGATIVA Fora da especificação exigida no termo de referência

Após detida análise, *afirmo* que a licitante empresa **Andréia Liguori Cardoso, CNPJ 29.218.243/0001-83 (andamento 19 do subprocesso 32687/1) 2ª colocada arrematante do item 1**, apresentou um equipamento **FORA** das especificações técnicas, **NÃO** atendendo as exigências mínimas exigidas pelo edital da Tomada de Preços n. 008/2021 para a execução do objeto deste certame.

III. DA ANÁLISE DO PREÇO DO PRODUTO

Quanto TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 informamos que prevalece o MENOR PREÇO para aquisição na licitação.

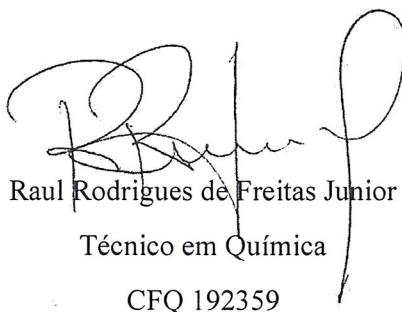


IV. DA CONCLUSÃO

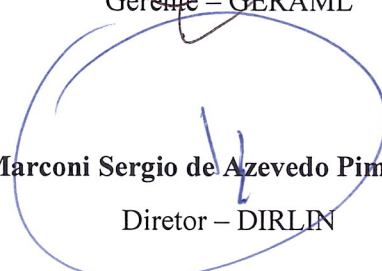
Diante do exposto, opto, destarte:

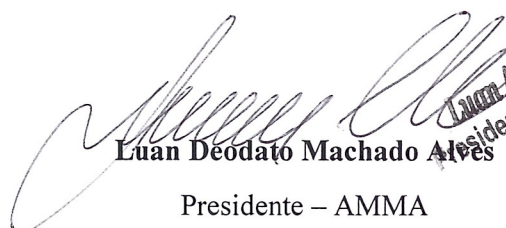
- a. Não está apta, tecnicamente, para participar do certame a empresa **Andréia Liguori Cardoso**, CNPJ 29.218.243/0001-83 (andamento 19 do subprocesso 32687/1) 2ª colocada arrematante do item 1, onde apresenta para aquisição de equipamento **Monitor de Sinais Vitais, o que está FORA do Termo de Referência** para atender a Agência Municipal de Meio Ambiente, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos por intermédio do pregão eletrônico nº 008/2021, cuja abertura ocorreu no 02/07/2021, às 09:00 horas.
- b. Que seja solicitada a adequação do equipamento referente ao analisador de gases conforme termo de referência.

É o parecer


Raul Rodrigues de Freitas Junior
Técnico em Química
CFQ 192359


Quim. Antônio Junio Gonçalves da Cruz
Gerente – GERAML


Marconi Sergio de Azevedo Pimenteira
Diretor – DIRLIN


Luan Deodato Machado Alves
Presidente – AMMA

